

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 368/49 (พบ.)

หมายเลข คณ. 6515 - M - 63 - S - 2755

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หัวจี้ในน้ำแบบตัดและหัวจี้ห้ามเลือดด้วยคลื่นความถี่สูง |
(Arthroscopic Radio Frequency Probe)

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้ตัดเนื้อเยื่อ กระดูกอ่อน และห้ามเลือดโดยใช้คลื่นความถี่ (Radio Frequency) แบบ Bipolar หรือแบบ Monopolar ในสารละลายให้พลังงานความร้อนต่ำ สามารถใช้ร่วมกับกล้องส่องข้อในการผ่าตัด

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค ทำด้วยโลหะปลอดสนิม หรือดีกว่า

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

①

- 1.3.1 หัวจี้แบบก้านตรงปลายหักมุม
- 1.3.2 หัวจี้แบบก้านตรงปลายตัดหักมุม
- 1.3.3 หัวจี้ Capsule Shrinkage ก้านตรงปลายตรง
- 1.3.4 หัวจี้แบบก้านตรงปลายหัก มีสายต่อดูตุน้ำได้
- 1.3.5 หัวจี้แบบปลายตรง
- 1.3.6 หัวจี้แบบตักแต่งเส้นเอ็นขนาดเล็ก
- 1.3.7 หัวจี้สำหรับเจาะหมอนรองกระดูก ก้านตรงปลายตรง
- 1.3.8 หัวจี้แบบต่อน้ำหยด ก้านตรงปลายตรงปลายโค้ง
- 1.3.9 หัวจี้แบบมีท่อหยด ก้านตรงปลายหักมุม 90 องศา
- 1.3.10 เข็มเจาะน้ำพร้อมบล็อก
- 1.3.11 บรรจุซองละ 1 อัน ปราศจากเชื้อ

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันส่งของ
- 3.2 ขนาดและรูปแบบ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

/คณะกรรมการ...

พ.อ. 

- 7 พ.ค. 2563

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หัวจี้ในน้ำแบบตัดและหัวจี้ห้ามเลือดด้วยคลื่นความถี่สูง
(Arthroscopic Radio Frequency Probe)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ
(ปุณฺชทร ทิพยวงษ์)

พ.อ.หญิง.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.อ.....ศัลยแพทย์โรคกระดูก รพ.ร.ร.6/
(ณีฐา กุลกำธร) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

- 7 พ.ค. 2563

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พล.ต.....ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(สุพิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ.....นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ
(ปราโมทย์ จันทมิฬ)

19 พ.ค. 2563

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้มีให้มี
คามอนุมัติ อก.พบ.ท้ายหนังสือ กวค.ทบ.
ที่ กท 0446.13/ 717... ตจ. 25 พ.ค. 63

สำเนาถูกต้อง
อ.อ. (วิชัย ไชยวุฒิ)
นายทหารพยาบาล รพ.ร.ร.๖

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 372/49 (พบ.)

หมายเลข คณ. 6515 - M - 63 - S - 2759

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไบมีดและหัวกรอสำหรับตัดแต่งเนื้อเยื่อและกรอกระดูก

(Arthroscopic Shaver Blades and Burs)

หน่วยนับ อัน/ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้ในการตัดแต่งเนื้อเยื่อและกรอกระดูกสำหรับเครื่องตัดและกรอกระดูก โดยใช้ร่วมกับกล้องส่องข้อ (Arthroscope) เพื่อทำการวินิจฉัยหรือผ่าตัดโดยไม่ต้องเปิดแผลใหญ่

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค ทำด้วยโลหะปลอดสนิม หรือดีกว่า

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เครื่องมือตัดแต่งเนื้อเยื่อและกระดูก ประกอบด้วย

1.3.1 แบบไบมีดสำหรับตัดเนื้อเยื่อภายในช่องข้อแบบหัวเรียบ 2 ไบ

1.3.2 แบบไบมีดสำหรับตัดเนื้อเยื่อภายในช่องข้อแบบมีเขี้ยว 1 ไบ

2 1.3.3 แบบไบมีดสำหรับตัดเนื้อเยื่อภายในข้อแบบมีเขี้ยว 2 ไบ

1.3.4 แบบไบมีดสำหรับตัดเนื้อเยื่อภายในช่องข้อแบบหัวเรียบปลายตัด 2 ไบ

3 1.3.5 แบบหัวสำหรับกรอกระดูกแบบหัวกลม

4 1.3.6 แบบหัวสำหรับกรอกระดูกแบบหัวรูปไข่

1.3.7 แบบหัวสำหรับกรอกระดูกแบบยาว ปลายเรียว

1.3.8 ไบเลื่อยมีหลายขนาด จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.9 ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว บรรจุ 1 อัน ต่อ 1 ซอง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันส่งของ

3.2 ขนาดและรูปแบบ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

พ.อ.



/คณะกรรมการ...

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไบโอมิตและหัวกรอสำหรับตัดแต่งเนื้อเยื่อและกรอกระดูก
(Arthroscopic Shaver Blades and Burs)

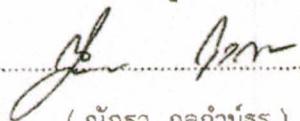
คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ. ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(ปุณชทร ทิพย์วงษ์)

พ.อ.หญิง ผอ.กอง พบ./กรรมการ

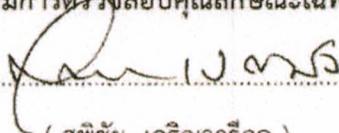
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.อ.  ศัลยแพทย์โรคกระดูก รพ.ร.ร.6/


(ณัฐรา กุลกำจร) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

- 7 พ.ค. 2563

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(สพิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ. ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ.  นบก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

(ปราโมทย์ จันทมิฬ)

19 พ.ค. 2563

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อำมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ ทวท.พบ.
ที่ ทท 0446.13/ 717 ลง 25 พ.ค. 63

สำเนาถูกต้อง 
(วิชัย ไชยวุฒิ)
นายทหารพยาบาล รพ.ร.ร.๖

5

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 370/49 (พบ.)

หมายเลข คณ. 6515 - M - 63 - S - 2757

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดเย็บซ่อมหมอนรองกระดูกข้อเข่า 5
(Meniscal Repair Set)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้ผ่าตัดเย็บหมอนรองกระดูกข้อเข่า สามารถใช้ร่วมกับกล้องส่องข้อโดยไม่ต้องเปิดแผลใหญ่

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค ทำจากโลหะปลอดสนิมสามารถโค้งงอและกลับเป็นเส้นตรงได้ตรง ปลายเป็นท่วงโลหะสำหรับร้อยไหมเย็บ หรือเป็นวัสดุที่ดีกว่า

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ ชุดสำหรับเย็บซ่อมหมอนรองกระดูกข้อเข่า เครื่องมือใช้เย็บพร้อมด้าย 1 ชุด ประกอบด้วย

1.3.1 ลูกดอกสำหรับซ่อมหมอนรองกระดูกข้อเข่า

1.3.2 ชุดเย็บซ่อมหมอนรองกระดูกข้อเข่า

1.3.3 ปลอกนำสำหรับช่วยส่งลูกดอกซ่อมหมอนรองข้อเข่า

1.3.4 ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว บรรจุ 1 ชุด ต่อ 1 ซอง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ ขนาดและรูปแบบ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง


4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดเย็บซ่อมหมอนรองกระดูกข้อเข่า
(Meniscal Repair Set)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ.  ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(ปุญชทร ทิพยวงษ์)

พ.อ.หญิง  ผอ.กอง พบ./กรรมการ

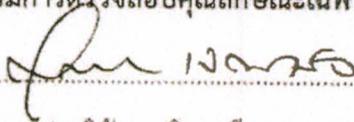
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.อ.  ศัลยแพทย์โรคกระดูก รพ.ร.6/


(ณัฏฐา กุลกำธร) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

- 7 พ.ค. 2563

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(สุพิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ.  ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ.  นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

(ปราโมทย์ จันทมิพ)

19 พ.ค. 2563

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้ *
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/ 717 ลง 25 พ.ค. 63

สำเนาถูกต้อง


(วิชัย ไชยวุฒิ)

นายทหารพยาบาล รพ.ร.๖

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 367/49 (พ.บ.)

หมายเลข คจ. 6515 - M - 63 - S - 2754

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วัสดุซ่อมเส้นเอ็นในข้อเข่าด้วยกล้องส่องข้อ
(Knee Arthroscope System Set)

หน่วยนับ ชิ้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เป็นวัสดุที่ใช้ในการทำผ่าตัดซ่อมเอ็นในข้อเข่าโดยใช้ร่วมกับกล้องส่องข้อ (Arthroscope)

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

6

1.2.1 สกรูยึดเอ็นข้อเข่าชนิดมีเกลียวแบบมีรูตรงกลางหรือสกรูยึดเอ็นข้อเข่าแบบพาดเอ็นในโพรงกระดูก มีรูตรงกลาง มี 2 ชนิด ดังนี้

1.2.1.1 แบบเป็นโลหะสแตนเลสปลอดสนิมหรือทำมาจากไททานเนียมอัลลอยด์ หรือดีกว่า

1.2.1.2 แบบละลายได้

1.2.2 อุปกรณ์เสริมสำหรับวัสดุผ่าตัดซ่อมเส้นเอ็นในข้อเข่า

1.2.2.1 ลวดนำใช้สำหรับให้เอ็นคล้องเพื่อผ่านวัสดุพาดเอ็นในโพรงกระดูกทำจากโลหะปลอดสนิม ส่วนปลายเป็นห่วงโลหะ

1.2.2.2 ปลอกกันน้ำออกแบบมีรูสำหรับสอดเครื่องมือผ่านได้ ทำจากพลาสติกมีวาล์วกันน้ำ ใช้กันน้ำในช่องโพรงกระดูกทั้งกระดูกหน้าแข้งและกระดูกต้นขา

1.2.2.3 ปลอกนำสำหรับใส่สกรูยึดกระดูก ทำจากพลาสติก มีช่องเปิดสำหรับใส่สกรูเพื่อขันเกลียวสกรูโดยเกลียวไม่ตัดเนื้อเยื่อข้างๆ

1.2.2.4 แผ่นรองขยายแผลผ่าตัด

1.2.2.5 ปลอกหุ้มกล้อง

1.2.2.6 เหล็กนำสำหรับใส่สกรูยึดกระดูก

1.2.2.7 เหล็กเจาะนำแบบมีรูร้อยไหมที่ปลาย

1.2.2.8 เหล็กนำเจาะกระดูก

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นวัสดุผ่าตัดซ่อมเส้นเอ็นในข้อเข่าด้วยกล้องส่องข้อ

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ รูปแบบและขนาด จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง


4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วัสดุซ่อมเส้นเอ็นในข้อเข่าด้วยกล้องส่องข้อ
(Knee Arthroscope System Set)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ.  ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ
(ปุณฺชทร ทิพยวงษ์)

พ.อ.หญิง  ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.อ.  ศัลยแพทย์โรคกระดูก รพ.ร.ร.6/
(ณีฐธา กุลกำธร) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
- 7 พ.ค. 2563

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(สุพิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ.  ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ.  นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ
(ปราโมทย์ จันทิมพิ)

19 พ.ค. 2563

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้มอบให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ที่ข.หนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 04:16.13/ 717 ตง. 25 พ.ค. 63

สำเนาถูกต้อง 
(วิชัย ไชยวุฒิ)
นายทหารพยาบาล รพ.ร.ร.๖

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 121/53 (พบ.)

หมายเลข คณ. 6515 - M - 63 - S - 2586

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วัสดุซ่อมเอ็นในข้อเท้า ๗
(Suture Button)

หน่วยนับ ชิ้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เป็นวัสดุที่ใช้ในการซ่อมเอ็นในข้อเท้าโดยใช้ร่วมกับกล้องส่องข้อ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- 1.2.1 วัสดุส่วนที่เป็นแท่งขนาดเล็ก ผลิตจากวัสดุพอลดสนิม หรือไททาเนียม หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า
- 1.2.2 วัสดุที่เป็นเส้นเอ็นสำหรับคล้อง ผลิตจากโพลีเอธิลีน หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่า หรือดีกว่า
- 1.2.3 เหล็กเจาะนำ ผลิตจากวัสดุพอลดสนิมหรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า
- 1.2.4 ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

(๗)

- 1.3.1 วัสดุส่วนที่เป็นแผ่นขนาดเล็กพร้อมวัสดุที่เป็นเส้นเอ็นสำหรับคล้อง ประกอบด้วย
 - 1.3.1.1 วัสดุที่เป็นแท่งขนาดเล็ก ความยาวไม่น้อยกว่า 12 มิลลิเมตร มีรูสำหรับร้อยเส้นเอ็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร
 - 1.3.1.2 วัสดุที่เป็นเส้นเอ็นสำหรับคล้อง มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร
- 1.3.2 เหล็กเจาะนำ มีรูสำหรับร้อยเส้นเอ็นที่ส่วนปลาย มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร
- 1.3.3 มีหลายขนาดให้เลือกตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละราย

- 2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- 3. ข้อกำหนดอื่นๆ ต้องเป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

/คณะกรรมการ...

พ.อ.



18 ก.พ. 2563

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วัสดุซ่อมเอ็นในข้อเข่า
(Suture Button)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.


พ.อ.  ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ
(ปุณฺชทร ทิพยวงษ์)

พ.อ.หญิง  ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.อ.  ศัลยแพทย์โรคกระดูก รพ.ร.6/
(ัญญา กุลกำธร) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
18 ก.พ. 2563

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทต.ทบ./ประธานกรรมการ
(สุพิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ.  ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ.  นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ
(ปราโมทย์ จันทิมห)

- 2 ธ.ค. 2563

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กพ 0446.13/347.ต. ๔๓.๑.๖3

สำเนาถูกต้อง


(วิชัย ไชยวุฒิ)
นายทหารพยาบาล รพ.ร.๖

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 366/49 (พบ.)

หมายเลข คฉ. 6515 - M - 63 - S - 2753

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดเครื่องมือเย็บซ่อมเส้นเอ็นบริเวณหัวไหล่โดยผ่านกล้องส่องข้อ
(Shoulder Arthroscope System Set)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ชุดอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่องตรวจหรือเย็บซ่อมเอ็น เนื้อเยื่อให้ติดกับกระดูก บริเวณหัวไหล่โดยใช้ร่วมกับกล้องส่องข้อ (Arthroscope)

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ชุดเย็บเอ็นหรือเนื้อเยื่อบริเวณข้อด้วยหมุดยึดแบบมีเกลียว แบบละลายได้และไม่ละลายพร้อม ไหมเย็บ และมีด้ามจับตัวหมุดทำจากโลหะปลอดสนิมมีหลายขนาด

8, 9, 11

1.2.2 ชุดสมอเย็บกระดูกแบบมีเกลียวพร้อมวัสดุยึดเอ็น แบบละลายได้และไม่ละลายตัวหมุดทำจาก โลหะปลอดสนิมหรือไททานเนียมแบบไม่ละลายหรือดีกว่า

1.2.3 ชุดถอดสมอยึดกระดูก เป็นปลอกพลาสติกสำหรับถอดสมอเย็บออกมาจากข้อไหล่

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นชุดเข็มร้อยไหมพร้อมด้ามจับปลายโค้งงอมีรูตรงกลางสำหรับสอดไหมหรือลวดใช้ในการช่วย เย็บซ่อมเอ็นบริเวณข้อต่างๆ

1.3.2 อุปกรณ์ประกอบในการใช้งาน

1.3.2.1 ชุดแท่งเหล็กสำหรับผูกเส้นไหมแบบมีปลอกดันปมไหมในตัว ปลายแท่งเหล็กมีรูร้อยไหม และมีปลอกพลาสติกดันปมไหมผูกภายใน

1.3.2.2 ชุดเหล็กนำเงาะพร้อมด้ามจับ เป็นแท่งโลหะมีรูทะลุพร้อมด้ามจับและมีแท่งเหล็กปลาย แหลมสำหรับเงาะกระดูกนำก้อนใส่โลหะเงาะกระดูกนำก้อนใส่โลหะ

10

1.3.2.3 ปลอกนำแบบมีเกลียวทำจากพลาสติกใสมีจุบปล่อยน้ำออกและมีวาล์วสำหรับเครื่องมือ เย็บซ่อมเส้นเอ็นบริเวณหัวไหล่ผ่านได้

1.3.3 ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว บรรจุของละ 1 ชิ้น

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต


3. ข้อกำหนดอื่นๆ ขนาดและรูปแบบ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

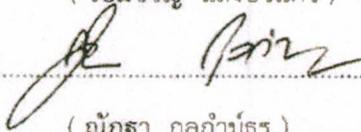
4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดเครื่องมือเย็บซ่อมเส้นเอ็นบริเวณหัวไหล่โดยผ่านกล้องส่องข้อ
(Shoulder Arthroscope System Set)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ.  ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ
(ปุณชทร ทิพยวงษ์)

พ.อ.หญิง  ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.อ.  ศัลยแพทย์โรคกระดูก รพ.ร.ร.6/
(ณิชฐา กุลกำธร) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
- 7 พ.ค. 2563

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(สุพิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ.  ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(ปกจิจ์ แสงสว่าง)

พ.อ.  นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ
(ปราโมทย์ จันทมิห)

19 พ.ค. 2563

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.ทบ.ที่ขอหนังสือ กวก.พ.บ.
ที่ กท 0446.137.117 กง. 25 พ.ค. 63

สำเนาถูกต้อง 50 
(วิชัย ไชยวุฒิ)
นายทหารพยาบาล รพ.ร.ร.๖